

1. Podstawa opinii:

formalna - ww. zlecenie;
merytoryczna – dane rynkowe.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) identyfikacja urządzenia, weryfikacja dokumentów,
- 2) ocena stanu technicznego i optycznego,
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- 4) opracowanie opinii.

3. Czas, miejsce i obecne osoby:

24.07.2019 r. , Lidzbark Warmiński, przedstawiciel Zleceniodawcy.

4. Metoda badań:


Organoleptyczna.


5. Dane techniczno – identyfikacyjne:

Analizator ChZT5 z sondą
Nr identyfikacyjny/seryjny: **BAC 309 915**
Marka: **Hoch Lange**
Typ: **BioTector TOC**
Data produkcji maszyny: **2012**

6. Ocena stanu:

Maszyna/urządzenie w dobrym stanie technicznym, kompletne - oryginalne.
Zgodnie z oświadczeniem przedstawiciela Zleceniodawcy – sprawne. Podczas oględzin nie uruchamiane.

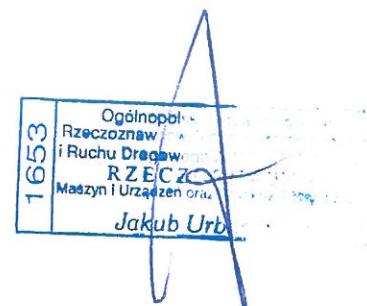

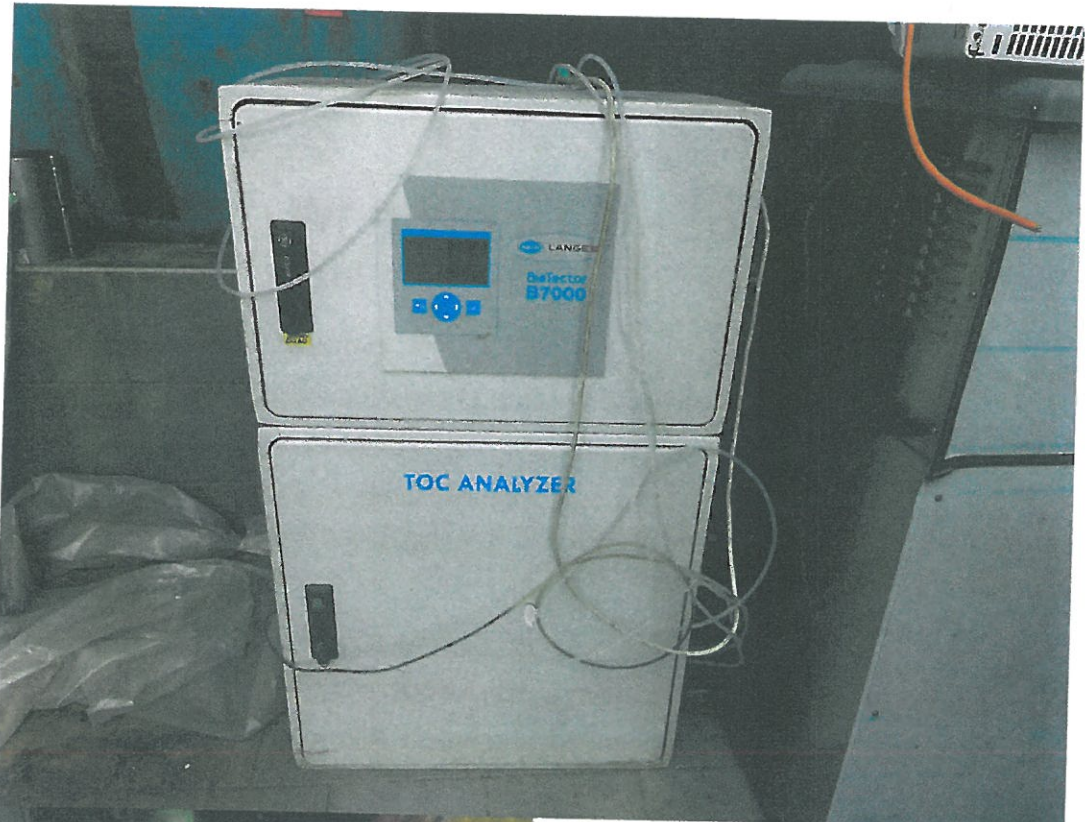

1653

Ogólnopolska
 Rzeczoznawcza
 i Ruchu Drogow
 RZECZ
 Maszyn i Urządzeń

Jakub Urb...